



Национальный
координационный
центр биобезопасности



Институт генетики и цитологии
Национальной академии наук
Беларуси




**Семинар-тренинг
14 февраля
г. Минск**

**Мозгова Галина Валерьевна
к.б.н.**

**руководитель Национального координационного центра
биобезопасности,
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси**

**g.mozgova@igc.by
biosafety.igc.by**

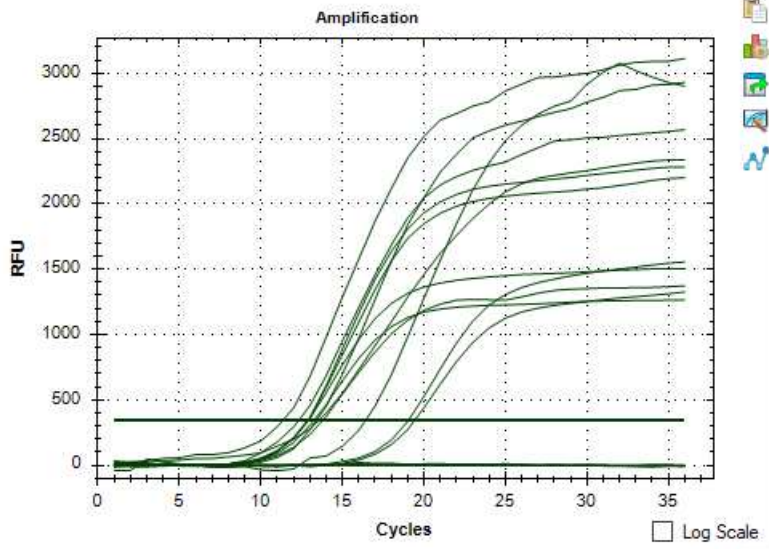


No wells designated as Sample Type standard.

FAM HEX

Step Number: 7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B			Unk	Unk	Unk	Unk	Unk	Unk	Unk	Unk		
C			Unk	Unk			NTC		NTC			
D												
E				Neg		Pos						
F				Neg		Pos						
G												
H												

Well	Fluor	Target	Content	Sample	Cq
B06	HEX		Unkn	4	12.30
B07	HEX		Unkn	5	11.33
B08	HEX		Unkn	6	13.38
B09	HEX		Unkn	7	13.52
B10	HEX		Unkn	8	16.40
C03	HEX		Unkn	9	13.23
C04	HEX		Unkn	10	12.87
C07	HEX		NTC		N/A
C09	HEX		NTC		N/A
E04	HEX		Neg Ctrl		N/A
E06	HEX		Pos Ctrl	pepino	19.41
F04	HEX		Neg Ctrl		N/A
F06	HEX		Pos Ctrl	pepino	19.04

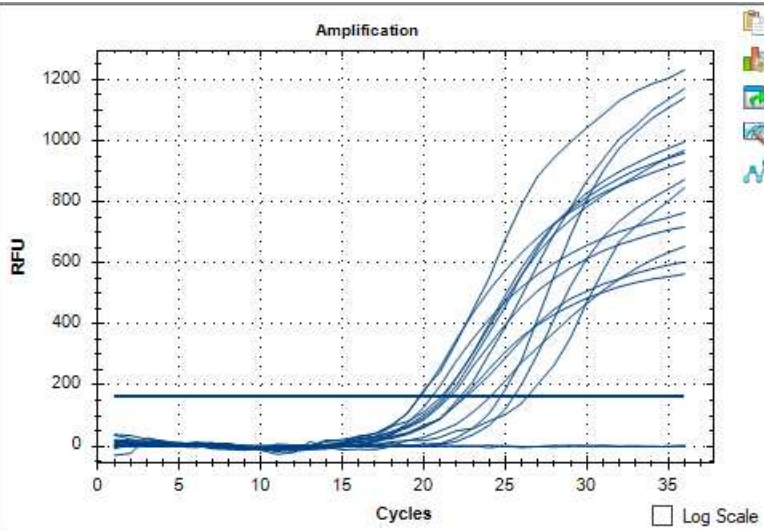

No wells designated as Sample Type standard.

FAM HEX

Step Number: 7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B			Unk	Unk	Unk	Unk	Unk	Unk	Unk	Unk		
C			Unk	Unk			NTC		NTC			
D												
E				Neg			Pos					
F				Neg			Pos					
G												
H												

Well	Fluor	Target	Content	Sample	Cq
B07	FAM		Unkn	5	19.72
B08	FAM		Unkn	6	22.23
B09	FAM		Unkn	7	24.09
B10	FAM		Unkn	8	26.36
C03	FAM		Unkn	9	22.45
C04	FAM		Unkn	10	21.60
C07	FAM		NTC		25.51
C09	FAM		NTC		24.71
E04	FAM		Neg Ctrl		N/A
E06	FAM		Pos Ctrl	pepino	20.50
F04	FAM		Neg Ctrl		N/A
F06	FAM		Pos Ctrl	pepino	19.79